
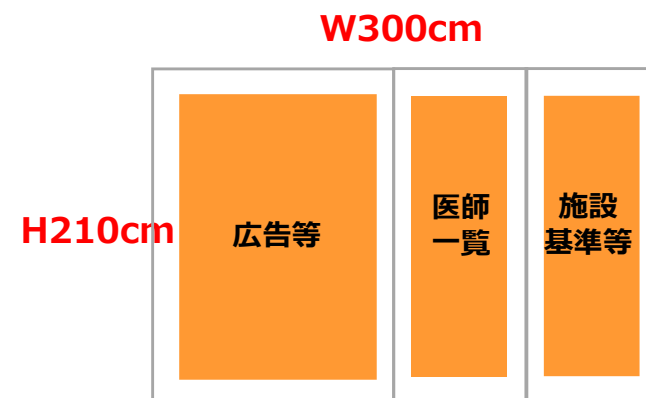


新病院広告付きデジタルサイネージ設置運営業務にかかる公募型プロポーザル 設置レイアウト・イメージ

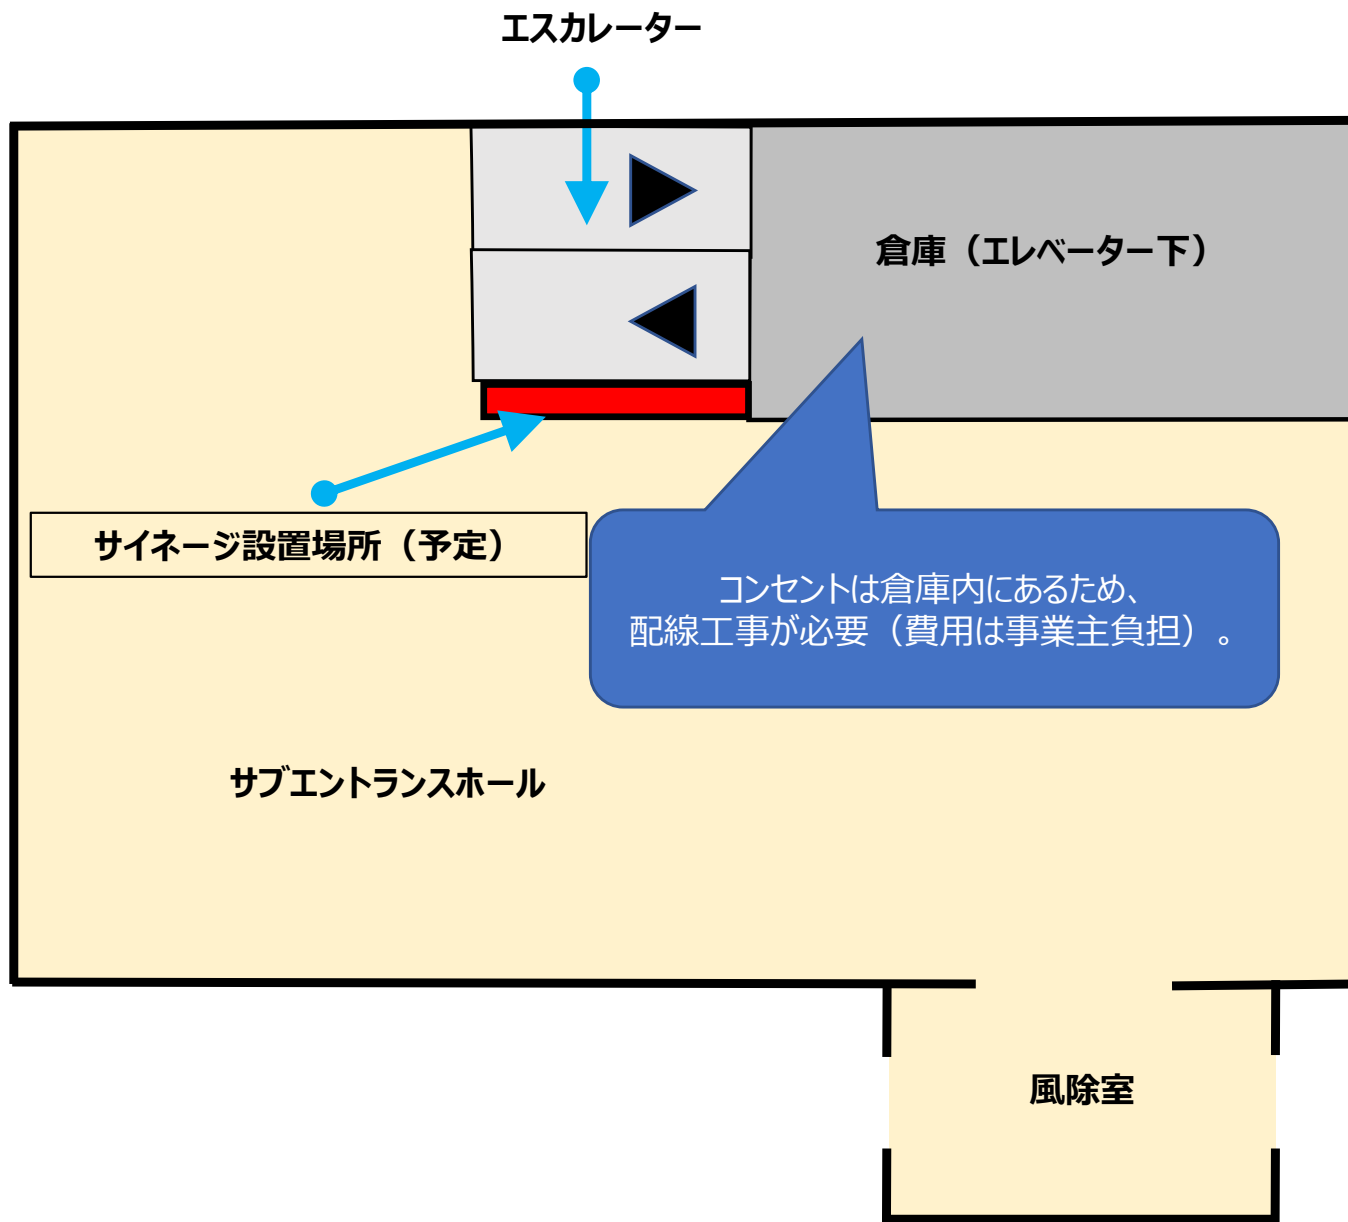

- ・筐体サイズ
高さは210cm程度とする。幅は300cmに納まるようにすること。
- ・設置方法
アンカー又はロック付きキャスター
- ・掲示内容
医師一覧、施設基準等の掲示内容を常時掲示すること。